

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФБУ «Нижегородский ЦСМ»

Ф. В. Балашов

« 10 » мая 2016 г.



**СЧЁТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СТАТИЧЕСКИЕ ОДНОФАЗНЫЕ
«Меркурий 206»**

Руководство по эксплуатации

Приложение Г

Методика поверки

АВЛГ.411152.032 РЭ1

с изменением № 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 Операции и средства поверки	4
2 Требования безопасности	6
3 Требования к квалификации поверителей	6
4 Условия поверки	6
5 Подготовка к поверке	6
6 Проведение поверки	7
7 Оформление результатов поверки	15
Приложение А – Форма протокола поверки	16
Приложение Б - Схема для проверки функционирования PLC-модема	17

[illegible]

Настоящая методика составлена с учётом требований Приказа Минпромторга № 1815 от 02.07.15, РМГ 51-2002, ГОСТ 8.584-2004, ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 22261-94 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной поверки счётчиков «Меркурий 206», а также объём, условия поверки и подготовку к ней.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Структура условного обозначения счётчиков, на которые распространяется настоящая методика поверки:

«Меркурий 206 PR(C)LSNOF_N»,

- **Меркурий** - торговая марка счётчика;
- **206** - серия счётчика;
- **P** – профиль мощности, журнал событий;
- **R** – интерфейс RS-485;
- **C** – интерфейс CAN;
- **L** – PLC-модем;
- **S** – внутреннее питание интерфейса;
- **N** – электронная пломба;
- **O** – встроенное реле;
- **FN** – встроенный радиомодем (N – разновидность радиомодема).

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Примечание - Отсутствие буквы в условном обозначении означает отсутствие соответствующей функции. Оптопорт присутствует во всех модификациях счётчика.

При выпуске счётчиков из производства и ремонта проводят первичную поверку.

Первичной поверке подлежит каждый счётчик.

Интервал между поверками 16 лет.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Периодической поверке подлежат счётчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.

Внеочередную поверку производят в случае:

- повреждения знака поверки и в случае утери формуляра;
- ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения (более половины межповерочного интервала);
- проведения повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на счётчик или неудовлетворительной его работе;
- продажи (отправки) потребителю счётчика, нереализованного по истечении срока, равного половине межповерочного интервала.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	<p>При выпуске счётчиков из производства и ремонта проводят первичную поверку.</p> <p>Первичной поверке подлежит каждый счётчик.</p> <p>Интервал между поверками 16 лет.</p> <p>(Измененная редакция, Изм. № 1)</p> <p>Периодической поверке подлежат счётчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении межповерочного интервала.</p> <p>Внеочередную поверку производят в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повреждения знака поверки и в случае утери формуляра; - ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения (более половины межповерочного интервала); - проведения повторной юстировки или настройки, известном или предполагаемом ударном воздействии на счётчик или неудовлетворительной его работе; - продажи (отправки) потребителю счётчика, нереализованного по истечении срока, равного половине межповерочного интервала. 	<div> <div>Лист</div> <div>3</div> </div>					
							<div> <div>АВЛГ.411152.032 РЭ1</div> </div>				
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1 Операции и средства поверки

1.1 Выполняемые при поверке операции, а также применяемые при этом средства поверки указаны в таблицах 1 и 1а соответственно.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Последовательность операций проведения поверки обязательна.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Обязательность проведения поверки	
		При первичной поверке	При периодической (внеочередной) поверке
1 Внешний осмотр	6.1	Да	Да
2 Проверка электрической прочности изоляции	6.2	Да	Да
3 Опробование	6.3	Да	Да
4 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО)	6.3а	Да	Да
5 Определение метрологических характеристик счётчика	6.4	Да	Да
5.1 Определение основной погрешности измерения активной и реактивной энергии	6.4.1	Да	Да
5.2 Проверка стартового тока (чувствительности).	6.4.2	Да	Да
5.3 Проверка отсутствия самохода	6.4.3	Да	Да
5.4 Определение основной погрешности измерения активной и реактивной мощности	6.4.4	Да	Да
5.5 Определение погрешности измерения напряжения и тока	6.4.5	Да	Да
5.6 Определение погрешности измерения частоты сетевого напряжения	6.4.6	Да	Да
5.7 Определение точности хода встроенных часов в нормальных условиях	6.4.7	Да	Да

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					АВЛГ.411152.032 РЭ1	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 1а - Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.1	В соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012.
6.2	Прибор для испытания электрической прочности УПУ-10: испытательное напряжение до 4 кВ, погрешность установки напряжения $\pm 5\%$. Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М: номинальное напряжение 230 В, ток (0,001-100) А, погрешность измерения активной энергии $\pm 0,15\%$, погрешность измерения реактивной энергии $\pm 0,3\%$.
6.3	Персональный компьютер: с операционной системой Windows. Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий». Программное обеспечение «BMonitorFEC». Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М: номинальное напряжение 230 В, ток (0,001-100) А, погрешность измерения активной энергии $\pm 0,15\%$, погрешность измерения реактивной энергии $\pm 0,3\%$. Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221». Оптоадаптер. Технологическое приспособление «RS-232 - PLC». Концентратор «Меркурий 225». Секундомер СОСпр-26-2: диапазон измерения (0-60) мин, класс точности 2.
6.3а	Персональный компьютер: с операционной системой Windows. Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий». Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221».
6.4	Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная УАПС-1М: номинальное напряжение 230 В, ток (0,001-100) А, погрешность измерения активной энергии $\pm 0,15\%$, погрешность измерения реактивной энергии $\pm 0,3\%$. Персональный компьютер: с операционной системой Windows. Программное обеспечение «Конфигуратор счётчиков Меркурий». Секундомер СОСпр-26-2: диапазон измерения (0-60) мин, класс точности 2. Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221». Источник питания постоянного тока Б5-30: постоянное напряжение (5-24) В, ток не менее 50 мА Частотомер электронно-счетный ЧЗ-64: диапазон измеряемых частот 0,1 Гц-100 МГц, погрешность измерения $2 \cdot 10^{-9}$.
<p>Примечания</p> <p>1 Допускается проведение поверки счётчиков с применением средств поверки, не указанных в таблице, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых счётчиков с требуемой точностью.</p> <p>2 Средства поверки должны быть поверены и иметь действующий знак поверки.</p>	

Таблица 1а (Введена дополнительно, Изм. № 1)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
АВЛГ.411152.032 РЭ1										5

2 Требования безопасности

2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требованиями раздела 1 руководства по эксплуатации АВЛГ.411152.032 РЭ и соответствующих разделов из документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 Поверку осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

3.2 Все действия по проведению измерений при проверке счётчиков электроэнергии и обработки результатов измерений проводят лица, изучившие настоящий документ, руководство по эксплуатации используемых средств измерений и вспомогательных средств поверки.

4 Условия поверки

4.1 Порядок представления счётчиков на поверку должен соответствовать требованиям Приказа Минпромторга России от 02.07.15 № 1815.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4.2 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

Температура окружающего воздуха, °С	23 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	от 630 до 795
Внешнее магнитное поле	отсутствует
Частота измерительной сети, Гц	50 ± 0,3
Форма кривой напряжения и тока измерительной сети	синусоидальная Кг не более 2 %
Отклонение номинального напряжения	±1,0 %

4.3 Поверка должна производиться на аттестованном оборудовании с применением средств поверки, имеющих действующий знак поверки.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

5 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

5.1 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств проверки, перечисленных в таблице 1.

5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) и знаков поверки у средств поверки.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

5.3 Проверить наличие заземления всех составных частей поверочной схемы.

5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить их работоспособность путём пробного пуска.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	<p>Относительная влажность воздуха, % Атмосферное давление, мм рт. ст. Внешнее магнитное поле Частота измерительной сети, Гц Форма кривой напряжения и тока измерительной сети</p> <p>Отклонение номинального напряжения</p>	<p>от 30 до 80 от 630 до 795 отсутствует $50 \pm 0,3$ синусоидальная Кг не более 2 % $\pm 1,0$ %</p>
					<p>4.3 Поверка должна производиться на аттестованном оборудовании с применением средств поверки, имеющих действующий знак поверки. (Измененная редакция, Изм. № 1)</p>	
<p>5 Подготовка к поверке</p> <p>Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:</p> <p>5.1 Проверить наличие и работоспособность основных и вспомогательных средств поверки, перечисленных в таблице 1.</p> <p>5.2 Проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации) и знаков поверки у средств поверки. (Измененная редакция, Изм. № 1)</p> <p>5.3 Проверить наличие заземления всех составных частей поверочной схемы.</p> <p>5.4 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с руководством по эксплуатации и проверить их работоспособность путём пробного пуска.</p>						
					АВЛГ.411152.032 РЭ1	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счётчика следующим требованиям:

- лицевая панель счётчика должна быть чистой и иметь чёткую маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации;
- во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввёрнуты до упора винты с исправной резьбой;
- на крышке зажимной колодки счётчика должна быть нанесена схема подключения счётчика к электрической сети;
- в комплекте счётчика должны быть: формуляр АВЛГ.411152.032 ФО и руководство по эксплуатации АВЛГ.411152.032 РЭ.

6.1.2 (Исключен, Изм. № 1)

6.2 Проверка электрической прочности изоляции

6.2.1 При проверке электрической прочности изоляции испытательное напряжение необходимо подавать, начиная с минимального или со значения рабочего напряжения. Увеличение напряжения до испытательного значения следует производить плавно или равномерно ступенями за время (5 - 10) с.

6.2.2 Результат проверки считают положительным, если электрическая изоляция выдерживает в течение одной минуты испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц между соединёнными между собой контактами 1-4 и контактами 5-10, соединёнными с «землёй».

6.3 Опробование

При опробовании проверяется:

- функционирование жидкокристаллического индикатора (ЖКИ),
- функционирование интерфейсов связи;
- функционирование PLC-модема.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div>АВЛГ.411152.032 РЭ1</div>					Лист				
										7				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.3.1 Проверка функционирования ЖКИ.

6.3.1.1 При включении счётчика необходимо проверить включение всех сегментов индикатора. Пример работающего ЖКИ приведён на рисунках 1 и 1а.

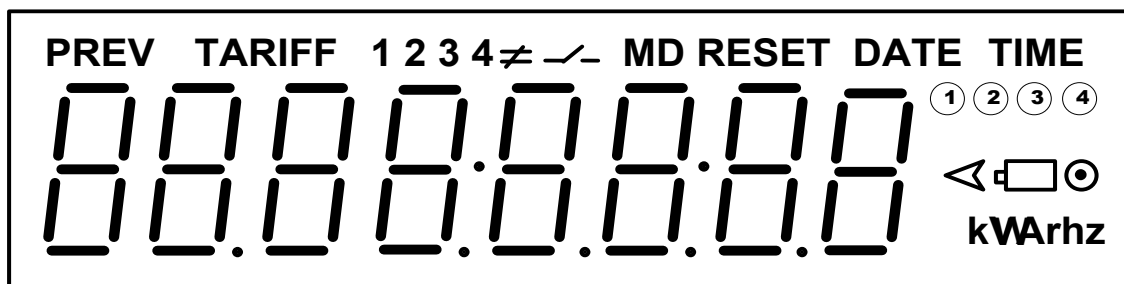


Рисунок 1

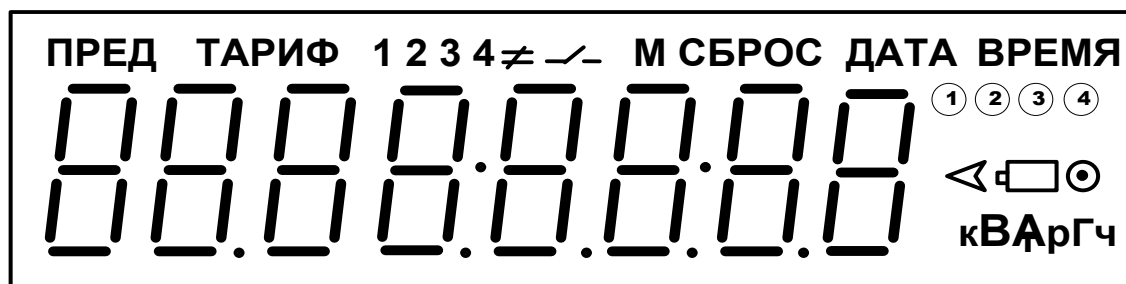


Рисунок 1а

6.3.1.2 Подключить счётчик к установке УАПС-1М.

Установить на УАПС-1М напряжение 230 В, ток в нагрузке отсутствует.

Записать значение потребленной электроэнергии с ЖКИ.

Установить на установке ток 10 А при коэффициенте мощности 1,0. При этом должно происходить увеличение значения потреблённой электроэнергии. По истечении 15 мин записать показания потреблённой электроэнергии. Разница в показаниях должна быть в пределах от 560 до 590 Вт·ч.

Если все описанные действия завершились успешно, то ЖКИ счётчика функционирует исправно.

6.3.2 Проверка функционирования интерфейсов и возможности программирования и считывания информации через интерфейс связи

6.3.2.1 Для проверки возможности программирования и считывания через интерфейс необходимо подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221».

Включить счётчик и компьютер.

Запустить программу «Конфигуратор счётчиков Меркурий».

6.3.2.2 Открыть вкладку «**Параметры связи**». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 2.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.3.1.2 Подключить счётчик к установке УАПС-1М. Установить на УАПС-1М напряжение 230 В, ток в нагрузке отсутствует. Записать значение потребленной электроэнергии с ЖКИ. Установить на установке ток 10 А при коэффициенте мощности 1,0. При этом должно происходить увеличение значения потреблённой электроэнергии. По истечении 15 мин записать показания потреблённой электроэнергии. Разница в показаниях должна быть в пределах от 560 до 590 Вт·ч. Если все описанные действия завершились успешно, то ЖКИ счётчика функционирует исправно. 6.3.2 Проверка функционирования интерфейсов и возможности программирования и считывания информации через интерфейс связи 6.3.2.1 Для проверки возможности программирования и считывания через интерфейс необходимо подсоединить к порту RS-232 персонального компьютера преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485 «Меркурий 221». Включить счётчик и компьютер. Запустить программу «Конфигуратор счётчиков Меркурий». 6.3.2.2 Открыть вкладку « Параметры связи ». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 2.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	АВЛГ.411152.032 РЭ1					Лист
										8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Рисунок 2

Выбрать тип счётчика «Меркурий 206», тип интерфейса, скорость обмена, номер порта. Нажать кнопку **«Соединить»**.

6.3.2.3 Проверка программирования и считывания тарифного расписания.

Для проверки чтения тарифного расписания необходимо выполнить операции п.6.3.2.1.

6.3.2.3.1 Открыть вкладку **«Тарифы»**. На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 3.

Считать тарифное расписание счётчика, нажав кнопку **«Прочитать из счётчика»**. При этом в таблице должно отобразиться тарифное расписание, которое было записано в него ранее.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	<p>высказать тип счётчика «Меркурий 200», тип интерфейса, скорость обмена, номер порта. Нажать кнопку «Соединить».</p> <p>6.3.2.3 Проверка программирования и считывания тарифного расписания.</p> <p>Для проверки чтения тарифного расписания необходимо выполнить операции п.6.3.2.1.</p> <p>6.3.2.3.1 Открыть вкладку «Тарифы». На экране должно появиться окно, изображённое на рисунке 3.</p> <p>Считать тарифное расписание счётчика, нажав кнопку «Прочитать из счётчика». При этом в таблице должно отобразиться тарифное расписание, которое было записано в него ранее.</p>	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АВЛГ.411152.032 РЭ1	Лист 9

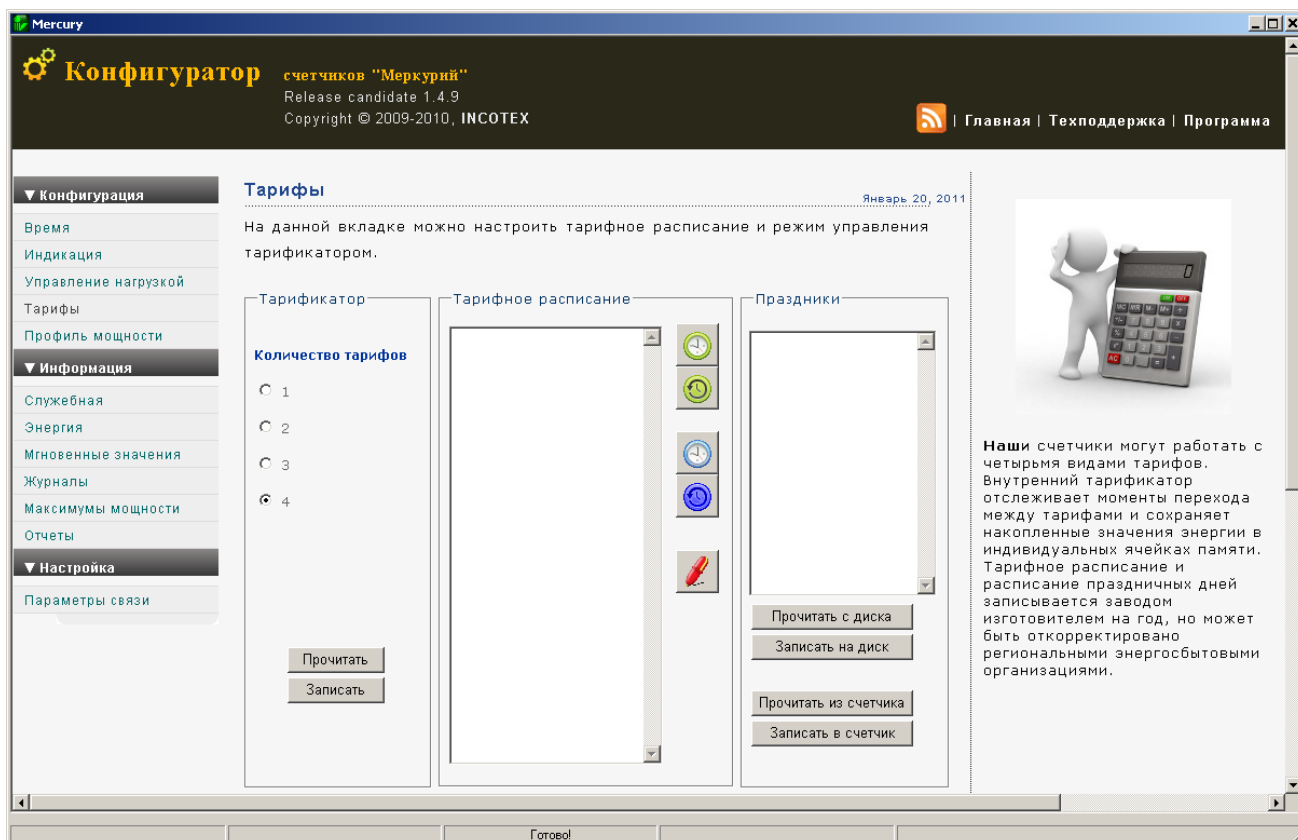


Рисунок 3

6.3.2.3.2 Для программирования тарифного расписание необходимо выбрать определённый день и месяц. Изменить тарифное расписание и записать его в счётчик, нажав кнопку «**Записать в счётчик**». Для проверки записанного нового тарифного расписания необходимо считать его из счетчика, выполнив операции п. 6.3.2.3.1.

Если описанные действия прошли успешно, то программирование и считывание тарифного расписания осуществлены правильно.

6.3.2.3.3 Аналогичным образом можно проверить программирование и считывание другой информации.

6.3.3 Проверка функционирования PLC-модема и возможности передачи и приёма информации через PLC-модем

6.3.3.1 Для проверки возможности передачи и приёма информации через PLC-модем счётчика необходимо собрать схему в соответствии с приложением Б.

Убедиться, что адрес PLC-модема установлен верно. Запустить программу «BMonitor». Включить технологическое приспособление (концентратор «Меркурий-225») и счётчик. Сконфигурировать концентратор. Через время не более 5 мин на экране монитора персонального компьютера (ПК) в соответствующем разделе (окне) программы «BMonitor» должно появиться значение накопленной энергии в кВт·ч в соответствии с текущим режимом работы счётчика.

Сравнить эти показания с показаниями на ЖКИ счётчика. Если они совпадают, то PLC-модем в счётчике функционирует нормально.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					АВЛГ.411152.032 РЭ1				Лист
									10

6.3а Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО)

Метрологически значимой частью является встроенное программное обеспечение (ВПО) прибора. ВПО прибора имеет следующие идентификационные признаки:

- Идентификационное наименование программного обеспечения «Меркурий 206.txt»;
- Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения 1.0;
- Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода) ЕАС8;
- Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения CRC16.

Для проверки соответствия ПО предусмотрена следующая процедура идентификации.

Подключить счётчик к компьютеру.

Включить питание персонального компьютера.

Запустить программу «Конфигуратор счётчиков Меркурий».

Нажать кнопку «Соединить».

После соединения со счётчиком открывается вкладка «Служебная», на которой отображаются идентификационные данные счётчика.

Вывод об аутентичности ВПО принимается по результатам сравнения отображаемых идентификационных данных с приведенными выше.

Подраздел 6.3а (Введен дополнительно, Изм. № 1)

6.4 Определение метрологических характеристик счётчика

6.4.1 Проверка стартового тока (чувствительности).

Проверку стартового тока производят на установке УАПС-1М при номинальном напряжении 230 В, коэффициенте мощности, равном единице, и значении тока 10 мА для счётчиков с $I_b = 5$ А и 20 мА для счётчиков с $I_b = 10$ А.

Перед началом проверки необходимо перевести импульсный выход счётчика в режим поверки.

Результаты проверки считаются положительными, если счётчик регистрирует электро-энергию: импульсный выход счётчика периодически меняет своё состояние (проверяется по светодиоду, который мигает в такт импульсному выходу).

6.4.2 Проверка отсутствия самохода

При проверке самохода установить в параллельной цепи счётчика напряжение 264,5 В. Ток в последовательной цепи должен отсутствовать. При этом необходимо контролировать с помощью секундомера период мигания светового индикатора потребляемой мощности счётчика на установке УАПС-1М.

Результаты проверки считаются положительными, если импульсный выход счётчика создает не более одного импульса в течение времени:

- 2,6 мин для счётчиков с максимальным током 100 А;
- 3,3 мин для счётчиков с максимальным током 80 А;
- 4,4 мин для счётчиков с максимальным током 60 А.

6.4.3 Определение погрешности счётчика при измерении активной и реактивной энергии производится методом непосредственного сличения на установке УАПС-1М. Перед началом поверки необходимо прогреть счётчик в течении 10 минут.

6.4.3.1 Погрешность счётчика при измерении активной энергии определяют при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблице 2.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	АВЛГ.411152.032 РЭ1					Лист	
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	11	

Таблица 2

Номер испы- тания	Параметры входных сигналов			Пределы допускаемой погрешности при из- мерении активной энергии, %	Время измерения, с
	напряжение, В	ток, А	cos φ		
1	230	0,05I _б	1,0	±1,5	60
2	230	0,1I _б	1,0	±1,0	60
3	230	I _б	1,0	±1,0	20
4	230	I _{max}	1,0	±1,0	5
5	230	0,1I _б	0,5инд	±1,5	90
6	230	0,1I _б	0,8емк	±1,5	90
7	230	0,2I _б	0,5инд	±1,0	60
8	230	0,2I _б	0,8емк	±1,0	60
9	230	I _б	0,5инд	±1,0	30
10	230	I _б	0,8емк	±1,0	30
11	230	I _{max}	0,5инд	±1,0	10
12	230	I _{max}	0,8емк	±1,0	10

Результаты поверки считаются положительными, и счётчик соответствует классу точности 1, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений погрешности, приведённых в таблице 2.

6.4.3.2 Погрешность счётчика при измерении реактивной энергии определяют при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Информативные параметры входного сигнала			Пределы допускаемой погрешности при из- мерении реактивной энергии, %	Время измере- ния, с
	напряжение, В	ток, А	Sin φ		
1	230	0,05I _б	1,0	±2,5	60
2	230	0,1I _б	1,0	±2,0	60
3	230	I _б	1,0	±2,0	20
4	230	I _{макс}	1,0	±2,0	5
5	230	0,1I _б	0,5инд	±2,5	90
6	230	0,1I _б	0,5емк	±2,5	90
7	230	0,2I _б	0,5инд	±2,0	60
8	230	0,2I _б	0,5емк	±2,0	60
9	230	I _б	0,5инд	±2,0	30
10	230	I _б	0,5емк	±2,0	30
11	230	I _{макс}	0,5инд	±2,0	10
12	230	I _{макс}	0,5емк	±2,0	10

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АВЛГ.411152.032 РЭ1

Лист

12

Результаты поверки считаются положительными, и счётчик соответствует классу точности 2, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений погрешности, приведённых в таблице 3.

6.4.4 Определение погрешности измерения активной и реактивной мощности производится методом сравнения со значением мощности, измеренной эталонным счётчиком в соответствии с формулами:

$$\delta P = \frac{P_{\text{изм}} - P_0}{P_0} \cdot 100, \%$$

$$\delta Q = \frac{Q_{\text{изм}} - Q_0}{Q_0} \cdot 100, \%$$

где $P_{\text{изм}}$, $Q_{\text{изм}}$, - значение активной, реактивной мощности, измеренное счётчиком;
 P_0 , Q_0 - значение активной, реактивной мощности, измеренное установкой.

Измерение активной и реактивной мощности необходимо проводить при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблицах 2 и 3.

Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения мощности находятся в пределах, рассчитываемых по формуле:

$$\delta p = \pm \left[K + 0,05 \left(\frac{P_{\text{max}}}{P} - 1 \right) \right],$$

где K – класс точности;
 P_{max} - максимальная мощность счётчика,
 P - измеренное значение мощности.

6.4.5 Определение погрешности измерения напряжения и тока производится методом сравнения со значениями напряжения и тока, измеренных эталонным счётчиком установки в соответствии с формулами:

$$\delta u = \frac{U_{\text{изм}} - U_0}{U_0} \cdot 100, \%$$

$$\delta i = \frac{I_{\text{изм}} - I_0}{I_0} \cdot 100, \%$$

где $U_{\text{изм}}$, $I_{\text{изм}}$ – значения напряжения и тока, измеренные счётчиком;
 U_0 , I_0 - значение напряжения и тока, измеренные эталонным счётчиком установки.

Измерение напряжения необходимо проводить при следующих значениях напряжения: $0,8U_{\text{ном}}$, $U_{\text{ном}}$, $1,15U_{\text{ном}}$.

Измерение тока необходимо проводить при следующих значениях тока: $0,05I_6$, $0,1I_6$, I_6 , $I_{\text{макс}}$.

Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения напряжения находятся в пределах $\pm 1,0 \%$.

Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения тока в диапазоне токов от $0,05I_6$ до I_6 находятся в пределах:

$$\delta i = \pm \left[1 + 0,4 \left(\frac{I_6}{I} - 1 \right) \right], \%$$

где I_6 - базовый ток счётчика,
 I - измеренное значение тока.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Результаты поверки считаются положительными, и счётчик соответствует классу точности 2, если во всех измерениях погрешность находится в пределах допускаемых значений погрешности, приведённых в таблице 3.</p> <p>6.4.4 Определение погрешности измерения активной и реактивной мощности производится методом сравнения со значением мощности, измеренной эталонным счётчиком в соответствии с формулами:</p> $\delta P = \frac{P_{\text{изм}} - P_0}{P_0} \cdot 100, \%$ $\delta Q = \frac{Q_{\text{изм}} - Q_0}{Q_0} \cdot 100, \%$ <p>где $P_{\text{изм}}$, $Q_{\text{изм}}$, - значение активной, реактивной мощности, измеренное счётчиком; P_0, Q_0 - значение активной, реактивной мощности, измеренное установкой.</p> <p>Измерение активной и реактивной мощности необходимо проводить при значениях информативных параметров входного сигнала, указанных в таблицах 2 и 3.</p> <p>Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения мощности находятся в пределах, рассчитываемых по формуле:</p> $\delta p = \pm \left[K + 0,05 \left(\frac{P_{\text{max}}}{P} - 1 \right) \right],$ <p>где K – класс точности; P_{max} - максимальная мощность счётчика, P - измеренное значение мощности.</p> <p>6.4.5 Определение погрешности измерения напряжения и тока производится методом сравнения со значениями напряжения и тока, измеренных эталонным счётчиком установки в соответствии с формулами:</p> $\delta u = \frac{U_{\text{изм}} - U_0}{U_0} \cdot 100, \%$ $\delta i = \frac{I_{\text{изм}} - I_0}{I_0} \cdot 100, \%$ <p>где $U_{\text{изм}}$, $I_{\text{изм}}$ – значения напряжения и тока, измеренные счётчиком; U_0, I_0 - значение напряжения и тока, измеренные эталонным счётчиком установки.</p> <p>Измерение напряжения необходимо проводить при следующих значениях напряжения: $0,8U_{\text{ном}}$, $U_{\text{ном}}$, $1,15U_{\text{ном}}$.</p> <p>Измерение тока необходимо проводить при следующих значениях тока: $0,05I_6$, $0,1I_6$, I_6, $I_{\text{макс}}$.</p> <p>Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения напряжения находятся в пределах $\pm 1,0 \%$.</p> <p>Результаты проверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения тока в диапазоне токов от $0,05I_6$ до I_6 находятся в пределах:</p> $\delta i = \pm \left[1 + 0,4 \left(\frac{I_6}{I} - 1 \right) \right], \%$ <p>где I_6 - базовый ток счётчика, I - измеренное значение тока.</p>				
					<div style="text-align: center;"> <p>АВЛГ.411152.032 РЭ1</p> </div>				
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения тока в диапазоне токов от I_6 до I_{\max} находятся в пределах $\pm 1,0 \%$.

6.4.6 Определение погрешности измерения частоты сетевого напряжения производится методом сравнения со значением частоты сети, измеренной с помощью частотомера ЧЗ-64 и рассчитывается по формуле:

$$\delta F = \frac{F_u - F_o}{F_o} \cdot 100, \%$$

где F_u – значение частоты, измеренное счётчиком;
 F_o – значение частоты, измеренное частотомером.

Измерение частоты необходимо проводить при следующих значениях частоты: 45 Гц; 50 Гц; 55 Гц.

Результаты поверки считаются положительными, если вычисленные погрешности измерения частоты находятся в пределах $\pm 0,5 \%$.

6.4.7 Определение точности хода встроенных часов

Определение точности хода встроенных часов производится во включенном состоянии.

Подключить счётчик к компьютеру. Импульсный выход счётчика подключить к частотомеру согласно рисунку 4.

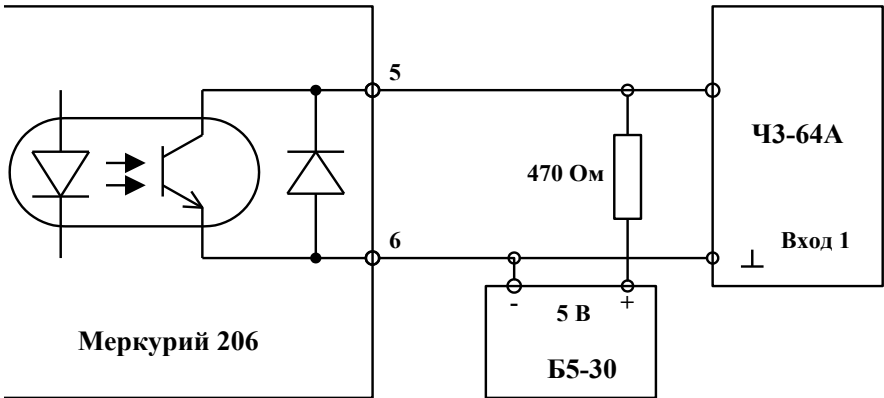


Рисунок 4

С помощью программы «Конфигуратор счётчиков Меркурий», перевести импульсный выход счётчика в режим поверки частоты кварца. Измерить период с относительной погрешностью не хуже 10^{-7} (измерение проводить по спаду).

Рассчитать точность хода часов без коррекции по формуле:

$$T_{\text{ч}} = \frac{86400 \cdot (t_{\text{ист}} - t_{\text{изм}})}{t_{\text{ист}}},$$

где $t_{\text{ист}}$ – период, равный 1/4096 Гц;

$t_{\text{изм}}$ – измеренный период

Рассчитать точность хода часов с учётом коррекции по формуле:

$$T = 86400/K + T_{\text{ч}},$$

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АВЛГ.411152.032 РЭ1	Лист
						14

где К – коэффициент коррекции, считанный из счётчика.

Результаты поверки считаются положительными, если точность хода часов находится в пределах $\pm 0,5$ с/сутки.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Положительные результаты поверки удостоверяются знаком поверки, наносимым давлением на навесную пломбу или специальную мастику и записью в формуляре, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки (оттиск), в соответствии с Приказом Минпромторга № 1815 от 02.07.15. Оформляется протокол (Приложение А).

7.2 Если по результатам поверки счётчик, признан непригодным к применению, выписывается извещение о непригодности к применению.

Раздел 7 (Измененная редакция, Изм. № 1)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АВЛГ.411152.032 РЭ1		Лист		
							15		

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № _____ от _____ 20__ г.

Счётчик типа _____ Зав№ _____ Год выпуска _____ Изготовитель _____

Принадлежит _____

Основные технические характеристики по ГОСТ (ТУ) _____

- класс точности или пределы допускаемой основной относительной погрешности _____

- номинальное напряжение _____ В

- номинальный ток _____ А

Дата предыдущей поверки _____

Поверочная установка типа _____ № _____ свидетельство о поверке установки

№ _____ от _____ 20__ г., срок действия до _____ 20__ г., эталонный счётчик

типа _____ № _____, предназначена для поверки счётчиков типа _____ и класса точности

_____ при соотношении основных относительных погрешностей эталонного и поверяемого счётчиков, не превышающем _____

Результаты поверки:

Внешний осмотр _____

Проверка изоляционных свойств _____

Опробование и проверка правильности работы счётного механизма и импульсного выхода _____

Подтверждение соответствия ПО _____

Проверка отсутствия самохода _____

Проверка порога чувствительности _____

Таблица А.1 – Результаты определения основной относительной погрешности в режимах симметрии и несимметрии нагрузок, а также значение разности погрешностей для различных режимов при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице

Напряжение, В	Нагрузка, % номинального тока	cosφ	Основная относительная погрешность, %	Разность погрешностей в режимах симметричной и несимметричной нагрузок, %

Заключение _____

Поверку провёл _____


подпись

имя, отчество, фамилия

					АВЛГ.411152.032 РЭ1	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема для проверки функционирования PLC-модема

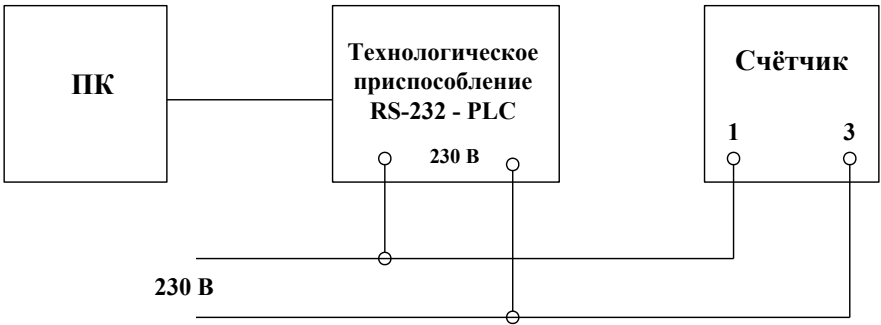

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
АВЛГ.411152.032 РЭ1				Лист
				17

Копировал

Формат А4

[illegible]

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

АВЛГ.411152.032 РЭ1

Лист

18